

TGI 是德国技术玻璃公司的缩写，公司位于德国中部拥有悠久玻璃制造历史的伊姆瑙，公司产品分为实验玻璃，家用玻璃，光学玻璃和玻璃原料等，公司秉承“德国制造”的严苛要求，员工和工程师均拥有熟练高超的玻璃制造和设计技能，为遍布全球的客户id提供各式的解决方案和优质产品。

TGI 硼硅玻璃 I-330 是一种满足实验室最高要求的玻璃，完全符合 DIN ISO 3585 国际标准对 3.3 硼硅玻璃的要求。对化学腐蚀，温度和热力学变化有出色的耐受性。玻璃成分如下： SiO_2 , 80%; B_2O_3 , 13%; Na_2O , 4%; Al_2O_3 , 2%; K_2O , 1%。

关于试剂瓶

硼硅玻璃 3.3 可适用于微波炉

灭菌：蒸汽灭菌最高 134°C ，2bar，20 分钟，盖子必须旋松以避免压力产生，内部压力过大可能会导致破裂

冷冻：低至 -40°C （瓶盖和防溅环不适合低于此温度），瓶子充满不超过 3/4，放置于倾角 45° 的位置

压力：不用于压力或真空的情况

关于体积计量器皿

A/AS 级：A/AS 级的体积计量器皿符合依据 DIN 和 ISO 定义的误差极限范围，并拥有 conformity 资格认证，其中 AS 级有个短暂的涌出时间（适用于移液管和滴定管），这个符合标准的时间可以观察到。

B 级：按照 DIN 和 ISO 的定义，B 级体积计量器皿的误差极限不超过 A/AS 级误差极限的两倍。

Conformity 认证

在 A/AS 级体积计量器皿中有标“ ”的，TGI 承诺携带有此 conformity 认证标记的相关产品是根据德国国家计量法令和相关标准生产

清洗和灭菌

玻璃器皿可以人工或者机器清洗，我们建议首次使用之前清洗所有玻璃部件，因为在运输和储存过程中无法完全避免污染。


玻璃器皿在短时低温和少量碱性环境中使用后，必须清洗干净。如果使用过传染性物质，所有部件清洗后必须灭菌。

避免超过 70°C 清洗带有刻度的玻璃器皿，特别是计量器皿，避免长时间浸泡在碱性溶液中，否则刻度可能被破坏。



产品

蓝盖瓶，也叫储存瓶或试剂瓶 Storage bottles

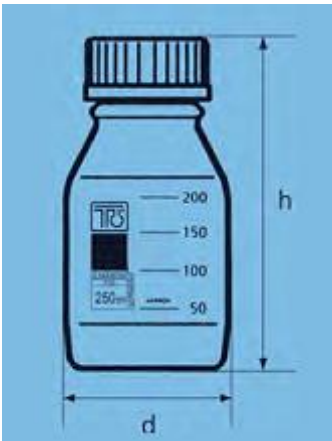


容量 (l) ml	直径 (d) mm	高度 (h) mm	包装	透 明 玻 璃 订货号(3379)	棕 色 玻 璃 订货号(3379)
100	56	100	10	TG 900503	TG 90050313
250	70	138	10	TG 900603	TG 90060313
500	86	176	10	TG 900703	TG 90070313
1000	101	225	10	TG 900803	TG 90080313
2000	136	260	10	TG 900903	TG 90090313
5000	181	330	1	TG 901803	TG 90180313
10000	227	410	1	TG 902003	TG 90200313
20000	288	505	1	TG 902503	TG 90250313

DIN GL45 外螺纹口，带刻度，蓝色螺纹盖，PP 防漏环，硼硅玻璃 3.3
其他规格请咨询

刻度量筒，高型 Measuring cylinders, tall form
六边形底座，B 级，DIN EN ISO 4788，硼硅玻璃 3.3

容量 ml	分刻度 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订货号(3374)	棕 色 刻 度 订货号 (3374)
5	0.1	10	TG 100111	TG 100112
10	0.2	10	TG 100211	TG 100212
25	0.5	10	TG 100311	TG 100312
50	1.0	10	TG 100411	TG 100412
100	1.0	10	TG 100511	TG 100512
250	2.0	10	TG 100611	TG 100612
500	5.0	10	TG 100711	TG 100712
1000	10.0	10	TG 100811	TG 100812
2000	20.0	10	TG 100911	TG 100912

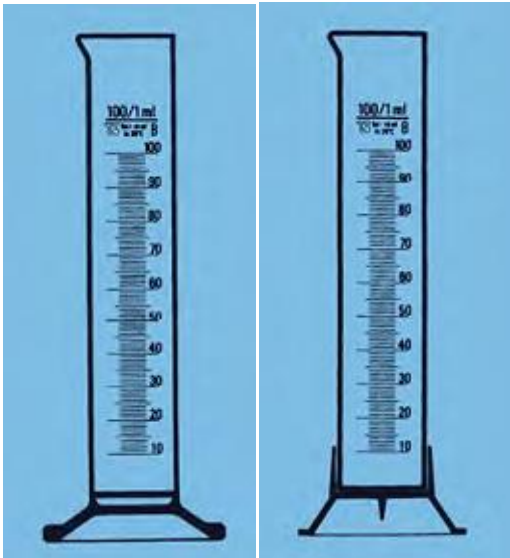

刻度量筒，高型 Measuring cylinders, tall form
六边形底座，A 级，DIN EN ISO 4788，硼硅玻璃 3.3

容量 ml	分刻度 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订货号 (3374)
5	0.1	10	TG 100142
10	0.2	10	TG 100242
25	0.5	10	TG 100342
50	1.0	10	TG 100442
100	1.0	10	TG 100542
250	2.0	10	TG 100642
500	5.0	10	TG 100742
1000	10.0	10	TG 100842
2000	20.0	10	TG 100942

刻度量筒，高型 Measuring cylinders, tall form
塑料可脱卸底座，B 级，DIN EN ISO 4788，钠钙玻璃

容量 ml	分刻度 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订货号 (0074)
10	0.2	10	TG 200211
25	0.5	10	TG 200311
50	1.0	10	TG 200411
100	1.0	10	TG 200511
250	2.0	10	TG 200611
500	5.0	10	TG 200711
1000	10.0	10	TG 200811

刻度移液管 Measuring pipettes AS
ILMABOR® 完全排出，零刻度位于顶部，AS 级，
等待时间 5 秒，DIN EN ISO 385，钠钙玻璃

容量 ml	分刻度 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订 货 号 (0071)	棕 色 刻 度 订 货 号 (0071)
0.5	0.01	10	TG 1101211	TG 1101221
1	0.01	10	TG 1102211	TG 1102221
2	0.02	10	TG 1103211	TG 1103221
5	0.05	10	TG 1104211	TG 1104221
10	0.1	10	TG 1106211	TG 1106221
25	0.1	10	TG 1107211	TG 1107221
50	0.5	10	TG 1108211	TG 1108221

容量大于 5ml（包含 5ml）的都有一个特别的顶部设计，可以放置棉花塞，有利于延长排出时间，提高精度



刻度移液管 Measuring pipettes AS 
ILMABOR® 完全排出，零刻度位于顶部，AS 级，**conformity**
认证，等待时间 5 秒，DIN EN ISO 385，钠钙玻璃

容量 ml	分刻度 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订 货 号 (0071)	棕 色 刻 度 订 货 号 (0071)
0.5	0.01	10	TG 1101311	TG 1101321
1	0.01	10	TG 1102311	TG 1102321
2	0.02	10	TG 1103311	TG 1103321
5	0.05	10	TG 1104311	TG 1104321
10	0.1	10	TG 1106311	TG 1106321
25	0.1	10	TG 1107311	TG 1107321
50	0.5	10	TG 1108311	TG 1108321

胖肚移液管 Volumetric pipettes AS
单一刻度，AS 级，等待时间 15 秒，DIN EN ISO 648，
钠钙玻璃

容量 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订 货 号 (0071)	棕 色 刻 度 订 货 号 (0071)
0.5	10	TG 200121	TG 200122
1	10	TG 200221	TG 200222
2	10	TG 200321	TG 200322
5	10	TG 200421	TG 200422
10	10	TG 200521	TG 200522
20	10	TG 200621	TG 200622
25	10	TG 200721	TG 200722
50	10	TG 200821	TG 200822
100	10	TG 200921	TG 200922

胖肚移液管 Volumetric pipettes AS 
单一刻度，AS 级，**conformity** 认证，等待时间 15 秒，
DIN EN ISO 648，钠钙玻璃


容量 ml	包 装	蓝 色 刻 度 订 货 号 (0071)	棕 色 刻 度 订 货 号 (0071)
0.5	10	TG 200131	TG 200132
1	10	TG 200231	TG 200232
2	10	TG 200331	TG 200332
5	10	TG 200431	TG 200432
10	10	TG 200531	TG 200532
20	10	TG 200631	TG 200632
25	10	TG 200731	TG 200732
50	10	TG 200831	TG 200832
100	10	TG 200931	TG 200932



容量瓶 Volumetric flasks A

梨形，PP 瓶塞，A 级，蓝色标示，透明玻璃，
DIN EN ISO 1042，硼硅玻璃 3.3

容量 ml	磨口	包装	含 瓶 塞 订货号(3373)	不 含 瓶 塞 订货号(3373)
5	7/16	10	TG 2001417	TG 2001410
10	7/16	10	TG 2002417	TG 2002410
20	10/19	10	TG 2011417	TG 2011410
25	10/19	10	TG 2003417	TG 2003410
50	12/21	10	TG 2004417	TG 2004410
100	12/21	10	TG 2005417	TG 2005410
200	14/23	10	TG 2006417	TG 2006410
250	14/23	10	TG 2007417	TG 2007410
500	19/26	10	TG 2008417	TG 2008410
1000	24/29	10	TG 2009417	TG 2009410
2000	29/32	6	TG 2010417	TG 2010410
5000	34/35	1	TG 2018417	TG 2018410

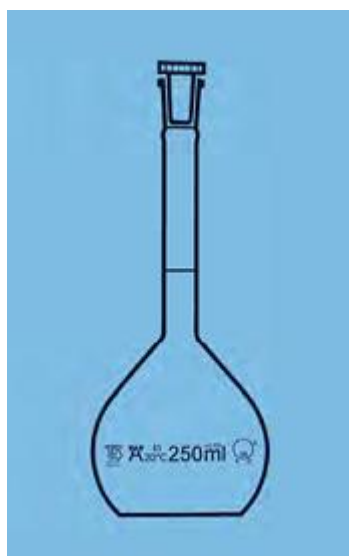

容量瓶 Volumetric flasks A H


梨形，PP 瓶塞，A 级，**conformity** 认证，蓝色标示，
透明玻璃，DIN EN ISO 1042，硼硅玻璃 3.3

容量 ml	磨口	包装	订货号 (3373)
5	7/16	2	TG 2001917
10	7/16	2	TG 2002917
20	10/19	2	TG 2011917
25	10/19	2	TG 2003917
50	12/21	2	TG 2004917
100	12/21	2	TG 2005917
200	14/23	2	TG 2006917
250	14/23	2	TG 2007917
500	19/26	2	TG 2008917
1000	24/29	2	TG 2009917
2000	29/32	2	TG 2010917
5000	34/35	1	TG 2018917

容量瓶 Volumetric flasks A

梨形，PP 瓶塞，A 级，白色标示，**棕色玻璃**，
DIN EN ISO 1042，硼硅玻璃 3.3

容量 ml	磨口	包装	订货号 (3373)
5	7/16	2	TG 2201437
10	7/16	2	TG 2202437
20	10/19	2	TG 2211437
25	10/19	2	TG 2203437
50	12/21	2	TG 2204437
100	12/21	2	TG 2205437
200	14/23	2	TG 2206437
250	14/23	2	TG 2207437
500	19/26	2	TG 2208437
1000	24/29	2	TG 2209437

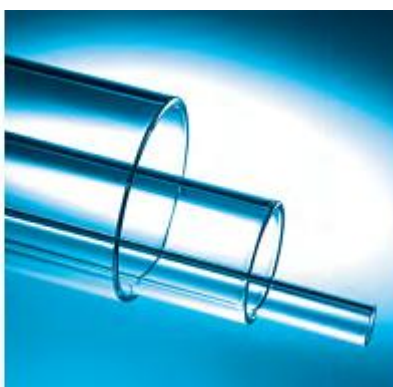

上海骊葆科学仪器有限公司
Shanghai Linbo Scientific Instrument Co.,Ltd.

电话: 021-52682768 服务热线: 13601711768
E-mail: bright.lu@linbo-china.com
http: //www.linbo-china.com